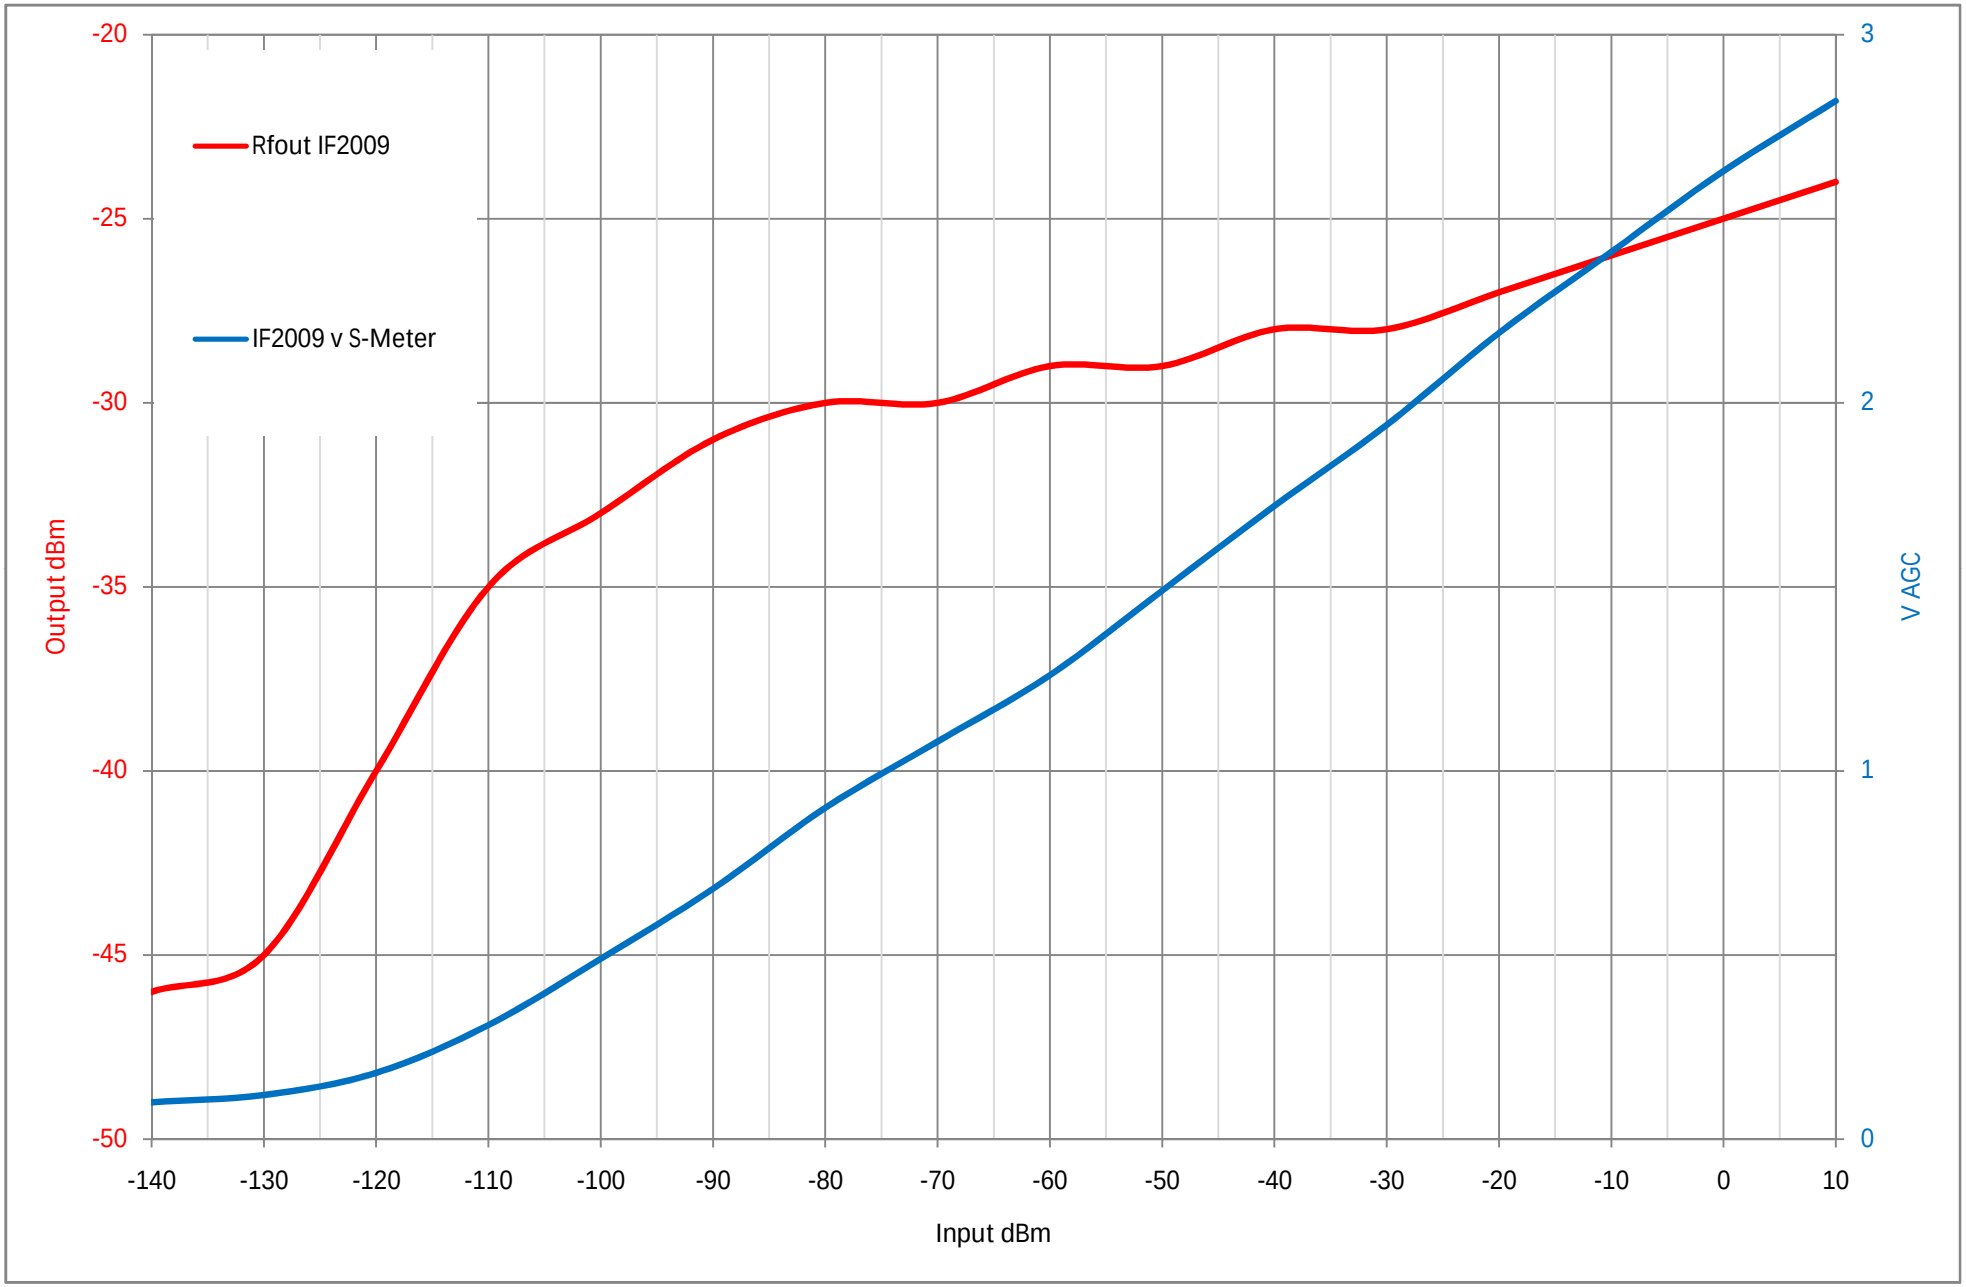
Rfout IF2009
IF2009 v S-Meter
Output dBm
V AGC
Input dBm
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
3
2
1
0
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10